



# Kit di strumenti.

Ampia Scelta di Kit  
per lo Studio Dentistico  
e per il Laboratorio  
Odontotecnico



Quality Products  
Made in Germany



I prodotti e le denominazioni riportati nel presente testo sono in parte protetti dal diritto d'autore, dal diritto dei marchi e dai rispettivi brevetti. La mancata apposizione di particolari indicazioni e/o del marchio ® non esclude la sussistenza di un'eventuale tutela giuridica.

La presente opera è protetta dal diritto d'autore. Tutti i diritti, ivi compresi quelli di traduzione, riproduzione e duplicazione, totali o parziali, sono riservati. Nessuna parte della presente opera può essere riprodotta o diffusa con un qualsivoglia mezzo (fotocopia, microfilm o qualsiasi altro mezzo) nonché rielaborata con l'ausilio di sistemi elettronici senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Con riserva di modifiche attinenti prodotti e colori. Non si risponde di eventuali errori di stampa.

## Studio

4624	5 argomenti a favore di Komet	4
4362	Set per il trattamento parodontale	4
4561	Set introduttivo CeraTip	4
4261	Set per inlay	5
4275	Set per inlay	5
4383	Set per il restauro a invasività minimale, secondo il Dr. Stefan Neumeyer	6
4405	Set per l'odontoiatria pediatrica secondo il Dr. Sellmann	6
4336 A	Set per lavorazioni occlusali	7
4337	Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer	7
4337	Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer	8
4337 F	Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer	8
LD 0731	Set Conservativa Cavità e Restauri AIC	9
LD 0999	Set di preparazione per otturazioni diretti dei denti anteriori e posteriori	9
TD 2726	Set restauri adesivi anteriori e posteriori sec. Dr. Veneziani Marco - Vigolzone(Pc)	10
TD 2727	Set per intarsi sec. Dr. Veneziani Marco - Vigolzone (Pc)	10
4547	Set Introduttivo K1SM CeraBur	11
4547	Set Introduttivo K1SM CeraBur	11
LD 0334	Set per l'escavazione dentinale controllata con rosette in ZrO <sub>2</sub>	11
SD 1219 A	Set per escavazione dentinale a basso sviluppo di vibrazioni Assortimento di 48 pz.	12
SD 1743	Set per escavazione dentinale a basso sviluppo di vibrazioni. Collo non interferente. Assortimento 28 pz.	13
4388	Set per Veneer ceramiche, secondo il Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg	14
LD 1000	Set di preparazione per rivestimenti e onlay/overlay	14
4092	Set finitura di compositi con strumenti diamantati	15
4159	Set rifinitura di compositi con strumenti in carburo di tungsteno	15
4282	Set di lime diamantate per la rifinitura interdentale di otturazioni in composito	16
4389	Set per la finitura di compositi, secondo il Prof. Radlanski	16
4546	Set per la finitura e lucidatura di compositi in 2 passaggi	17
4312 A	Set gommini per compositi impregnati di grani di diamante	17
4313 B	Set gommini per ceramica impregnati di grani di diamante	18
LD 1001	Set di rifinitura per otturazioni diretti dei denti anteriori e posteriori	18
4180	Set TPS2 per inlay, ponti e corone secondo il Dr. Bernard Touati, Paris	19
4278	Set per preparazioni ceramiche integrali UNI Göttingen	19
4333	Set Procera® per restauri in ceramica integrale con Procera® AllCeram	20
4384	Set Protesi con strumenti a piolino-guida sec. Dr. Günay	20
4394	Ergo-Präp-Set - set per la preparazione delle corone e ponti secondo il Dott. Sven Rinke	21
4410	Set per preparazioni ceramiche integrali con pin-guida, secondo il Dr. Julian Brandes	21
4548	Set per la lavorazione intraorale del titanio	22
4562	Set professionale per inlay e corone parziali in ceramica, sec. Il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster	22
4573	Set professionale per corone in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster 23	23
4589	Set per costruzioni a 0° di ZrO <sub>2</sub>	23

4637	Set per l'adattamento e la lucidatura di ZrO <sub>2</sub>	24
4333 C	Set di Preparazione Procera® AllCeram per restauri in ceramica integrale con Procera® AllCeram	24
4384 A	Set per la preparazione di monconi con pin-guida, secondo il Prof. Günay	25
4562 ST	Set professionale per inlay e corone parziali in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Dr. Pröbster	25
4573 ST	Set professionale per corone in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster 26	26
LD 0346 A	Set chamfer modificato versione autoclavabile sec. Dr. Massironi, Melegnano	26
LD 0569	Controlled vertical finishing line preparation with probing burs acc. to Dr. Bruna and Dr. Fabianelli	27
LD 0692	Set Intarsi Adesivi sec. Dr. Paolo Ferrari	27
LD 1023	Set preparazione protesica a linee di chiusura verticali	28
LD 1057	Set Preparazione Protesica sec. Dr. M. Fradeani, Pesaro	28
TD 1215 A	Porcelain Laminate Veneer - Preparazione delle faccette sec. il Dott. Galip Gürel	29
TD 1272	Set per la tecnica del chamfer modificato sec. Dr. Massironi, Melegnano	29
TD 1654	Set chamfer modificato sec. Dr. Massironi, Melegnano	30
TD 1655	Set corone complete in ceramica integrale, faccette e intarsi sec. Dr. Massironi, Melegnano	30
TD 645	Set per preparazioni protesiche sec. Dr. Castellani, Firenze	31
TD 725	Set per la preparazione protesica con disegno a chamfer modificato, cilindrico, sec. Dott. Massironi	31
TD 860	Set per la preparazione protesica con disegno a, chamfer modificato, conico, sec. Dr. Massironi, Melegnano	32
4646	Kit Endo Access	32
LD 1250 A	Apertura Camera Pulpare Dr. Giuseppe Squeo-Bari	33
LD 0294	Set H162SL per osteotomia, rizotomia, apicectomia, coronotomia	33
LD 0347	Set per piccola chirurgia orale	33
LD 0542	Set per chirurgia orale sec. i Dottori Clauser e Barone, Firenze	33

## Laboratorio

4399 A	Set per la lucidatura delle ceramiche	34
SD 1873	Set introduttivo con gommini Pin	34
SORT 031	Set introduttivo moscioni 9485C/M/F	35
TD 1160 A	Set dischi diamantati	35
4409	Set per la lavorazione di provvisori secondo l'assistente dentale J. Mettler	36
4447	Set per la lavorazione di ZrO <sub>2</sub> secondo il tecnico Jan Holger Bellmann	36
TD 1211	Set minifresoni GTI per titanio	37
TD 1248	Set minifresoni UM per leghe	37
TD 1520 A	Set per correzioni protesiche	38
TD 2041	Lavorazione di abutment in titanio con turbina da laboratorio sec. Od. J.H Bellmann	38
TD 2817	Set per rifinire i provvisori sec. Dr. Massironi, Melegnano	39
TD 867 B	Set per Rifinitura Provvisori sec. Dr. M. Fradeani, Pesaro	39



new

4 4624.000

5 argomenti a favore di Komet

	K1SM.204.018	1		
	H390UF.314.018	1		
	S6830L.314.012	1		
	H390Q.314.018	1		
	H4MCL.314.012	1		



4561.314



Set introduttivo CeraTip

	KT.314.016	2	



4362.000



Set per il trattamento parodontale












	8831.204.012	1	
	831EF.204.012	1	
	8832.204.014	1	
	832EF.204.014	1	
	8831L.204.012	1	
	831LEF.204.012	1	
	8832L.204.014	1	
	832LEF.204.014	1	
	190.205.010	1	
	189.204.012	1	



**4261.314**



Set per inlay












			
	959KR.314.018	1	
●	8959KR.314.018	1	
●	959KREF.314.018	1	
	845KR.314.018	1	
●	8845KR.314.018	1	
●	845KREF.314.018	1	
	845KR.314.025	1	
●	8845KR.314.025	1	
●	845KREF.314.025	1	
●	856EF.314.012	1	



**4275.314**



Set per inlay

			
	835KR.314.012	1	
	835KR.314.014	1	
	836KR.314.014	1	
	836KR.314.016	1	
	836KR.314.018	1	
●	8835KR.314.014	1	
●	8836KR.314.014	1	
●	8836KR.314.016	1	
●	8836KR.314.018	1	
●	8856.314.012	1	



6

**4383.314**



Set per il restauro a invasività minimale, secondo il Dr. Stefan Neumeyer

	<b>H249M.314.007</b>	1	
●	<b>H7SM.314.009</b>	1	
●	<b>H1SM.314.014</b>	1	
	<b>883AM.314.007</b>	1	
	<b>955AM.314.007</b>	1	
	<b>957AM.314.007</b>	1	

**4405.000**



Set per l'odontoiatria pediatrica secondo il Dr. Sellmann

●	<b>S6830RL.314.012</b>	1	
●	<b>6801.314.018</b>	1	
●	<b>H1SE.204.025</b>	1	
●	<b>H1SEM.204.014</b>	1	
●	<b>6379.314.023</b>	1	
	<b>801.313.014</b>	1	
	<b>838M.313.007</b>	1	
	<b>9403.204.055</b>	1	
	<b>889M.313.007</b>	1	
●	<b>6856.313.016</b>	1	



**4336 A.000**



Set per lavorazioni occlusali

	905.313.018	1	
	905.313.023	1	
	905.313.027	1	
	905.313.031	1	
●	8905.313.018	1	
●	8905.313.023	1	
●	8905.313.027	1	
●	8905.313.031	1	
○	H379UF.314.014	1	
○	H390UF.314.016	1	



**4337.313**



Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer

	889M.313.007	1	
	838M.313.007	1	
	830RM.313.009	1	
	830M.313.012	1	
	953M.313.014	1	
	953AM.313.014	1	




8

**4337.314**



Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer

<b>889M.314.007</b>	1		
<b>838M.314.007</b>	1		
<b>830RM.314.009</b>	1		
<b>830M.314.012</b>	1		
<b>953M.314.014</b>	1		
<b>953AM.314.014</b>	1		

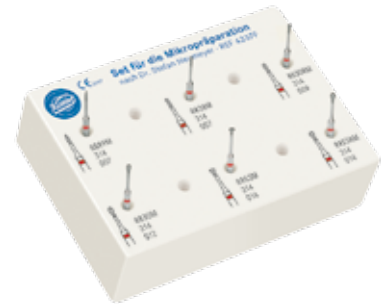

**4337 F.314**



Set per la micropreparazione, secondo il Dr. Stefan Neumeyer

<b>8889M.314.007</b>	1		
<b>8838M.314.007</b>	1		
<b>8830RM.314.009</b>	1		
<b>8830M.314.012</b>	1		
<b>8953M.314.014</b>	1		
<b>8953AM.314.014</b>	1		





**new**

**LD 0731.000**



Set Conservativa Cavità e Restauri AIC

	845.314.009	1	
	838.314.010	1	
	801.315.012	1	
	801.315.016	1	
●	8830L.314.012	1	
●	8390.314.014	1	
	862.314.010	1	
●	8862.314.010	1	
●	H1SEM.204.010	1	
●	H1SEM.204.014	1	
●	K1SM.204.016	1	



**LD 0999.000**

Set di preparazione per otturazioni diretti dei denti anteriori e posteriori


●	H7S.314.010	1	
	835KR.314.010	1	
●	8862.314.010	1	
●	H1S.204.014	1	
	10839.314.014	1	
●	K1SM.204.018	1	
	801.314.012	1	
●	H1S.204.010	1	
●	8801.314.014	1	
●	H48LF.314.012	1	



10 TD 2726.000

Set restauri adesivi anteriori e posteriori sec. Dr. Veneziani Marco - Vigolzone (Pc)

845.314.009	1		
838.314.010	1		
801.314.012	1		
801.314.016	1		
801.314.009	1		
● 8830L.314.010	1		
● 8390.314.014	1		
● 8862.314.010	1		
● 8368.314.023	1		
889M.314.007	1		
9608.314.030	1		
● H1S.314.018	1		
● K1SM.204.010	1		
● K1SM.204.014	1		
● K1SM.204.016	1		
○ 9523UF.204.030	1		
9645M.204.060	1		
9684.204.040	1		
9638.900.190	1		
303.204.	1		

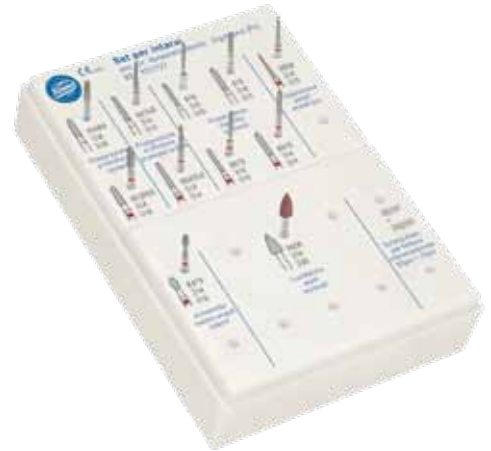

TD 2727.000

Set per intarsi sec. Dr. Veneziani Marco - Vigolzone (Pc)

959KR.314.018	1		
● 8959KR.314.018	1		
847KR.314.014	1		
● 8847KR.314.014	1		
878.314.010	1		
878.314.014	1		
● 8878.314.010	1		
● 8878.314.014	1		
● 8858.314.010	1		
● 8379.314.016	1		
9608.314.030	1		
● DS25F.000.	1		
● DS25EF.000.	1		



4547.204



Set Introduttivo K1SM CeraBur

●	K1SM.204.010	2	
●	K1SM.204.014	2	
●	K1SM.204.018	2	
●	K1SM.204.023	2	



4547.205



Set Introduttivo K1SM CeraBur


●	K1SM.205.010	2	
●	K1SM.205.014	2	
●	K1SM.205.018	2	
●	K1SM.205.023	2	



LD 0334.000

Set per l'escavazione dentinale controllata con rosette in ZrO<sub>2</sub>

●	K1SM.204.010	1	
●	K1SM.204.012	1	
●	K1SM.204.014	1	
●	K1SM.204.016	1	
●	K1SM.204.018	1	
●	K1SM.204.021	1	
●	K1SM.205.010	1	
●	K1SM.205.012	1	
●	K1SM.205.014	1	
●	K1SM.205.016	1	
●	K1SM.205.018	1	
●	K1SM.205.021	1	

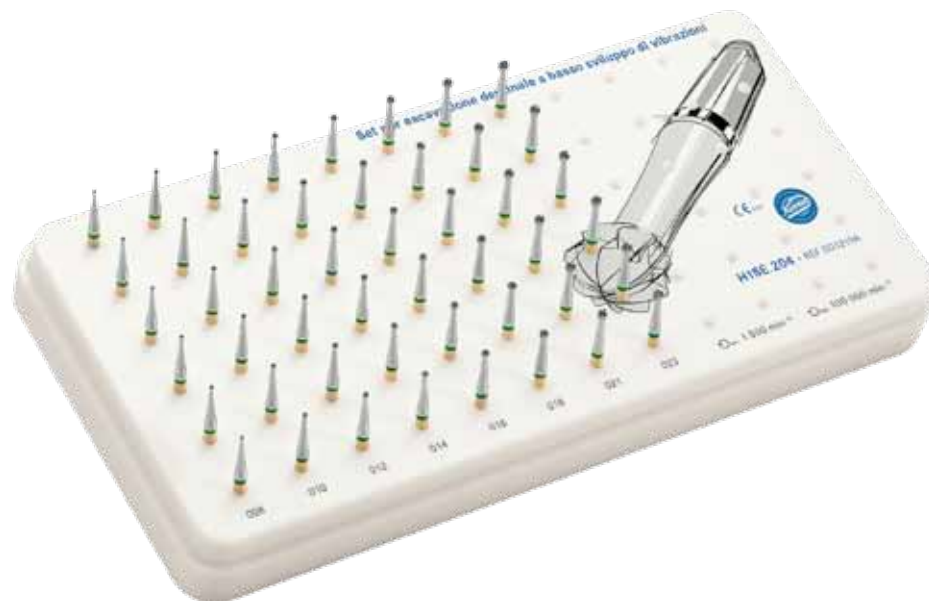

12 SD 1219 A.204

Set per escavazione dentinale a basso sviluppo di vibrazioni  
Assortimento di 48 pz.

●	H1SE.204.008	6	
●	H1SE.204.010	6	
●	H1SE.204.012	6	
●	H1SE.204.014	6	
●	H1SE.204.016	6	






●	H1SE.204.018	6	
●	H1SE.204.021	6	
●	H1SE.204.023	6	





**SD 1743.204**



Set per escavazione dentinale a basso sviluppo di vibrazioni. Collo non interferente  
Assortimento 28 pz.

●	<b>H1SEM.204.010</b>	4	
●	<b>H1SEM.204.012</b>	4	
●	<b>H1SEM.204.014</b>	4	
●	<b>H1SEM.204.016</b>	4	
●	<b>H1SEM.204.018</b>	4	

●	<b>H1SEM.204.021</b>	4	
●	<b>H1SEM.204.023</b>	4	



14 **4388.314**



Set per Veneer ceramiche, secondo il Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg

	<b>868B.314.018</b> 1		
	<b>868B.314.020</b> 1		
	<b>868.314.012</b> 1		
	<b>868.314.016</b> 1		
	<b>379.314.023</b> 1		
●	<b>8868.314.012</b> 1		
●	<b>8868.314.016</b> 1		
●	<b>8379.314.023</b> 1		
●	<b>852EF.314.014</b> 1		
●	<b>379EF.314.023</b> 1		



**LD 1000.000**

Set di preparazione per rivestimenti e onlay/overlay

	<b>951KR.314.023</b> 1		
●	<b>H1S.204.018</b> 1		
	<b>10839.314.014</b> 1		
●	<b>8951KR.314.024</b> 1		
	<b>880.314.012</b> 1		
	<b>868B.314.020</b> 1		
●	<b>6879.314.012</b> 1		
●	<b>8879.314.012</b> 1		



**4092.314**



Set finitura di compositi con strumenti diamantati

●	8955.314.008	1		
●	8956.314.010	1		
●	8852.314.014	1		
●	8859.314.014	1		
●	955EF.314.008	1		
●	956EF.314.010	1		
●	852EF.314.014	1		
●	859EF.314.014	1		
●	8379.314.023	1		
●	8957.314.007	1		
●	8957.314.009	1		
●	379EF.314.023	1		
●	957EF.314.007	1		
●	957EF.314.009	1		



**4159.314**



Set rifinitura di compositi con strumenti in carburo di tungsteno

●	H132.314.008	1		
●	H133.314.010	1		
●	H134.314.014	1		
●	H135.314.014	1		
●	H132F.314.008	1		
●	H133F.314.010	1		
●	H134F.314.014	1		
●	H135F.314.014	1		
○	H132UF.314.008	1		
○	H133UF.314.010	1		
○	H134UF.314.014	1		
○	H135UF.314.014	1		
●	H379.314.023	1		
●	H247.314.007	1		
●	H247.314.009	1		



16 **4282.000**



Set di lime diamantate per la rifinitura interdentale di otturazioni in composito

	<b>DF1EF.000.</b>	1		
	<b>DF1F.000.</b>	1		
	<b>DF1.000.</b>	1		
	<b>DF1C.000.</b>	1		

Per contrangoli a movimento reciproco



**4389.314**



Set per la finitura di compositi, secondo il Prof. Radlanski

	<b>H134Q.314.014</b>	1		
	<b>H135Q.314.014</b>	1		
	<b>H379Q.314.023</b>	1		
	<b>H390Q.314.018</b>	1		
	<b>H22AGK.314.016</b>	1		
	<b>H22ALGK.314.016</b>	1		
	<b>H379AGK.314.023</b>	1		
	<b>H390AGK.314.018</b>	1		





**4546.000**



Set per la finitura e lucidatura di compositi in 2 passaggi

	<b>H135Q.314.014</b>	1		
	<b>H48LQ.314.012</b>	1		
	<b>H379Q.314.023</b>	1		
	<b>H390Q.314.018</b>	1		
	<b>9524UF.204.050</b>	1		
	<b>9526UF.204.100</b>	1		
	<b>9525UF.204.085</b>	1		
	<b>9523UF.204.030</b>	1		



**4312 A.204**



Set gommini per compositi impregnati di grani di diamante

	<b>9400.204.030</b>	1		
	<b>9401.204.030</b>	1		
	<b>9402.204.030</b>	1		
	<b>9403.204.055</b>	1		
	<b>9404.204.055</b>	1		
	<b>9405.204.055</b>	1		
	<b>9406.204.100</b>	1		
	<b>9407.204.100</b>	1		
	<b>9408.204.100</b>	1		



18

**4313 B.204**



Set gommini per ceramica impregnati di grani di diamante

<b>94000C.204.030</b>	1		
<b>94000M.204.030</b>	1		
<b>94000F.204.030</b>	1		
<b>94004C.204.060</b>	1		
<b>94004M.204.060</b>	1		
<b>94004F.204.060</b>	1		
<b>94005C.204.100</b>	1		
<b>94005M.204.100</b>	1		
<b>94005F.204.100</b>	1		



**LD 1001.000**

Set di rifinitura per otturazioni diretti dei denti anteriori e posteriori
















	<b>H41.204.018</b>	1	
	<b>H390.314.016</b>	1	
	<b>8379.314.021</b>	1	
	<b>831.204.012</b>	1	
	<b>H48LUF.314.012</b>	1	
	<b>6878P.314.014</b>	1	



**4180.314**



Set TPS2 per inlay, ponti e corone secondo il Dr. Bernard Touati, Paris

















●	<b>6889.314.010</b>	1	TPS2-1	
●	<b>8889.314.010</b>	1	TPS2-2	
●	<b>6883.314.010</b>	1	TPS2-3	
	<b>888.314.012</b>	1	TPS2-4	
	<b>868.314.012</b>	1	TPS2-5	
●	<b>6856.314.016</b>	1	TPS2-6	
●	<b>8856.314.016</b>	1	TPS2-7	
●	<b>6856.314.018</b>	1	TPS2-8	
●	<b>8856.314.018</b>	1	TPS2-9	
●	<b>6847KR.314.016</b>	1	TPS2-10	
●	<b>8847KR.314.016</b>	1	TPS2-11	
●	<b>6849.314.016</b>	1	TPS2-12	
●	<b>8368.314.016</b>	1	TPS2-13	
●	<b>5856.314.016</b>	1	TPS2-14	
●	<b>5368.314.023</b>	1	TPS2-15	



**4278.314**



Set per preparazioni ceramiche integrali UNI Göttingen

	<b>951KR.314.016</b>	1		
	<b>951KR.314.019</b>	1		
	<b>951KR.314.023</b>	1		
●	<b>8951KR.314.017</b>	1		
●	<b>8951KR.314.020</b>	1		
●	<b>8951KR.314.024</b>	1		
	<b>881.314.010</b>	1		
	<b>881.314.014</b>	1		
●	<b>8881.314.012</b>	1		
●	<b>8881.314.016</b>	1		
	<b>379.314.023</b>	1		
	<b>899.314.027</b>	1		
●	<b>8379.314.023</b>	1		
●	<b>8899.314.027</b>	1		
	<b>845KR.314.016</b>	1		
	<b>850.314.014</b>	1		



20 **4333.000**



Set Procera® per restauri in ceramica integrale con Procera® AllCeram

<b>878K.314.014</b>	1	
<b>878K.314.016</b>	1	
<b>878K.314.018</b>	1	
<b>368.314.023</b>	1	

Procera® è un prodotto/marchio della ditta Nobel Biocare, Svezia



**4384.314**



Set Protesi con strumenti a piolino-guida sec. Dr. Günay

<b>S6878K.314.012</b>	1	
<b>S6878K.314.016</b>	1	
<b>S6856.314.018</b>	1	
<b>8856.314.018</b>	1	
<b>878KP.314.021</b>	1	
<b>856P.314.021</b>	1	
<b>8878KP.314.021</b>	1	
<b>8856P.314.021</b>	1	
<b>6379.314.023</b>	1	
<b>661.314.420</b>	1	



**4394.314**



Ergo-Präp-Set - set per la preparazione delle corone e ponti secondo il Dott. Sven Rinke

●	6850.314.014	1	
●	6881.314.014	1	
	899.314.027	1	
●	895 1KR.314.017	1	
●	8881.314.016	1	
●	8899.314.027	1	



**4410.000**



Set per preparazioni ceramiche integrali con pin-guida, secondo il Dr. Julian Brandes

●	8372P.314.023	1	
●	8372PL.314.023	1	
●	8847KR.314.023	1	
●	8846KR.314.018	1	
	379.314.023	1	
	9653.204.060	1	
●	8845KR.314.025	1	
●	8845KR.314.018	1	
●	H50A.314.010	1	
●	6830LGK.204.014	1	



22

**4548.314**



Set per la lavorazione intraorale del titanio

●	<b>H856G.314.016</b>	1	
●	<b>H856G.314.018</b>	1	
●	<b>H847KRG.314.016</b>	1	
●	<b>H847KRG.314.018</b>	1	
●	<b>H379G.314.023</b>	1	
●	<b>H375R.314.016</b>	1	
●	<b>H375R.314.018</b>	1	
●	<b>H336.314.016</b>	1	
●	<b>H336.314.018</b>	1	
●	<b>H379.314.023</b>	1	



**4562.314**



Set professionale per inlay e corone parziali in ceramica, sec. Il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajt6, Dr. M6rig, Prof. Pr6bster

●	<b>6847KRD.314.016</b>	1	
	<b>959KRD.314.018</b>	1	
	<b>845KRD.314.025</b>	1	
●	<b>8862.314.012</b>	1	
	<b>801.314.023</b>	1	
●	<b>8847KR.314.016</b>	1	
●	<b>8959KR.314.018</b>	1	
●	<b>8845KR.314.025</b>	1	
●	<b>8862.314.016</b>	1	
●	<b>8379.314.023</b>	1	










Vedi anche il set professionale 4573/ST per corone in ceramica, pagina 26



**4573.314**



Set professionale per corone in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajt6, Dr. M6rig, Prof. Pr6bster

●	<b>6837KR.314.012</b>	1	
●	<b>6856.314.021</b>	1	
●	<b>6856.314.018</b>	1	
●	<b>6856.314.012</b>	1	
●	<b>6379.314.023</b>	1	
●	<b>6836KR.314.014</b>	1	
●	<b>8856.314.021</b>	1	
●	<b>8856.314.018</b>	1	
●	<b>8379.314.023</b>	1	

Vedi anche il set professionale 4562/ST per inlay e corone parziali in ceramica, pagina 25



**4589.315**



Set per costruzioni a 0° di ZrO<sub>2</sub>

● ○	<b>ZR986M.315.012</b>	1	
● ○	<b>ZR986F.315.012</b>	1	
● ○	<b>ZR986EF.315.012</b>	1	
○ ○	<b>ZR986UF.315.012</b>	1	



24 **4637.000**

Set per l'adattamento e la lucidatura di ZrO<sub>2</sub>

		<b>ZR379L.315.014</b>	1	
		<b>ZR8379L.315.014</b>	1	
		<b>ZR850.314.016</b>	1	
		<b>ZR8850.314.016</b>	1	
		<b>94020C.204.040</b>	1	
		<b>94020F.204.040</b>	1	
		<b>94022C.204.060</b>	1	
		<b>94022F.204.060</b>	1	



**4333 C.314**



Set di Preparazione Procera® AllCeram per restauri in ceramica integrale con Procera® AllCeram

		<b>6878K.314.014</b>	1	
		<b>6878K.314.016</b>	1	
		<b>6878K.314.018</b>	1	
		<b>6368.314.023</b>	1	

Procera® è un prodotto/marchio della ditta Nobel Biocare, Svezia




















**4384 A.314**



Set per la preparazione di monconi con pin-guida, secondo il Prof. Günay

			
	<b>878KP.314.018</b>	1	
	<b>878KP.314.021</b>	1	
●	<b>8878KP.314.018</b>	1	
●	<b>8878KP.314.021</b>	1	
	<b>856P.314.018</b>	1	
	<b>856P.314.021</b>	1	
●	<b>8856P.314.018</b>	1	
●	<b>8856P.314.021</b>	1	
●	<b>S6878K.314.012</b>	1	
●	<b>S6878K.314.016</b>	1	
●	<b>S6856.314.018</b>	1	
●	<b>8856.314.018</b>	1	
●	<b>6379.314.023</b>	1	
	<b>661.314.420</b>	1	












Il supplemento ideale per il set: le punte soniche SF8878KD (distale) e SF8878KM (mesiale) sono perfettamente adatte per la finitura delle superfici interprossimali



**4562 ST.314**



Set professionale per inlay e corone parziali in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Dr. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Dr. Pröbster

			
●	<b>6847KRD.314.016</b>	1	
	<b>959KRD.314.018</b>	1	
	<b>845KRD.314.025</b>	1	
●	<b>8862.314.012</b>	1	
	<b>801.314.023</b>	1	
●	<b>8847KR.314.016</b>	1	
●	<b>8959KR.314.018</b>	1	
●	<b>8845KR.314.025</b>	1	
●	<b>8862.314.016</b>	1	
●	<b>8379.314.023</b>	1	

Il contenuto corrisponde a quello del set 4562; questa versione è presentata in portastrumenti sterilizzabile  
Vedi anche il set professionale 4573/ST per corone in ceramica, pagina 26



26

**4573 ST.314**



Set professionale per corone in ceramica, sec. il Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Dr. Frankenberger, Dr. Hajt6, Dr. M6rig, Prof. Dr. Pr6bster

●	<b>6837KR.314.012</b>	1	
●	<b>6856.314.021</b>	1	
●	<b>6856.314.018</b>	1	
●	<b>6856.314.012</b>	1	
●	<b>6379.314.023</b>	1	
●	<b>6836KR.314.014</b>	1	
●	<b>8856.314.021</b>	1	
●	<b>8856.314.018</b>	1	
●	<b>8379.314.023</b>	1	

Il contenuto corrisponde a quello del set 4573; questa versione è presentata in portastrumenti sterilizzabile  
Vedi anche il set professionale 4562/ST per inlay e corone parziali in ceramica, pagina 25



**LD 0346 A.314**












Set chamfer modificato versione autoclavabile sec. Dr. Massironi, Melegnano

	<b>845.314.025</b>	1	
●	<b>8845.314.025</b>	1	
●	<b>2379.314.023</b>	1	
●	<b>8379.314.023</b>	1	
●	<b>2979.314.012</b>	1	
●	<b>2979.314.014</b>	1	
●	<b>2979.314.016</b>	1	
●	<b>6878.314.010</b>	1	
●	<b>8979.314.014</b>	1	
●	<b>8979.314.016</b>	1	
●	<b>S6979K.314.018</b>	1	
●	<b>8979K.314.018</b>	1	
●	<b>2979K.314.021</b>	1	
●	<b>8979K.314.021</b>	1	



**LD 0569.000**

Controlled vertical finishing line preparation with probing burs  
acc. to Dr. Bruna and Dr. Fabianelli








			
●	6859.314.018	1	
●	6368.314.023	1	
	811.314.033	1	
●	6862D.314.016	1	
●	6862D.314.012	1	
●	6863.314.012	1	
	H40.314.012	1	
●	8368.314.023	1	
	856.314.018	1	
●	8862.314.012	1	



**LD 0692.000**



Set Intarsi Adesivi sec. Dr. Paolo Ferrari

			
	846KR.314.016	1	
●	8846KR.314.016	1	
	959KRD.314.018	1	
●	8959KR.314.018	1	
	845KR.314.021	1	
●	8845KR.314.021	1	


**28** LD 1023.314

Set preparazione protesica a linee di chiusura verticali

	858.314.010	1	
●	S6862.314.012	1	
●	S6862.314.016	1	
●	8862.314.012	1	
●	8862.314.016	1	
●	S6863.314.012	1	
●	S6863.314.016	1	
●	8863.314.012	1	
●	8863.314.016	1	
●	S6368.314.023	1	
●	8368.314.023	1	



LD 1057.314












Set Preparazione Protesica sec. Dr. M. Fradeani, Pesaro

●	6877K.314.014	1	
●	8877K.314.014	1	
●	S6878K.314.012	1	
●	S6878K.314.016	1	
●	8878K.314.012	1	
●	8878K.314.016	1	
●	S6856.314.012	1	
●	8856.314.012	1	
●	S6881.314.012	1	
●	S6881.314.014	1	
●	8881.314.012	1	
●	8881.314.014	1	
●	S6862.314.012	1	
●	8862.314.012	1	
	858.314.010	1	
●	8889.314.009	1	
	846KR.314.016	1	
●	5909.314.040	1	
	811.314.037	1	
●	S6379.314.023	1	
	10839.314.012	1	
	9608.314.030	1	



**TD 1215 A.000**

Porcelain Laminate Veneer - Preparazione delle faccette sec. il Dott. Galip Gürel












			
			
			
●			
● ●			
			
●			
●			
			
			
			




**TD 1272.314**



Set per la tecnica del chamfer modificato sec. Dr. Massironi, Melegnano

			
●			
●			
●			
●			
●			
●			
●			
●			
●			
●			


Vi consigliamo di utilizzare anche la punta sonora SF979 per il margine gengivale

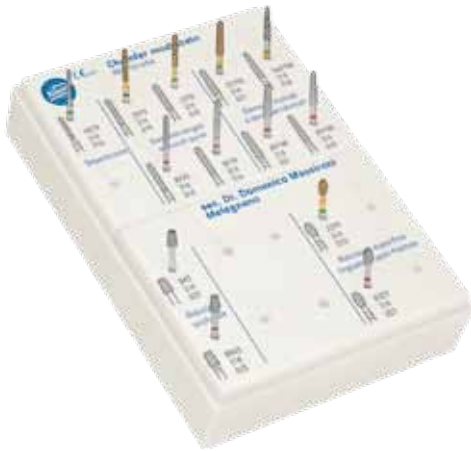

30 TD 1654.314

Set chamfer modificato sec. Dr. Massironi, Melegnano

	845.314.025	1	
●	8845.314.025	1	
●	2379.314.023	1	
●	8379.314.023	1	
●	2979.314.014	1	
●	2979.314.016	1	
●	6878.314.010	1	
●	8979.314.014	1	
●	8979.314.016	1	
●	S6979K.314.018	1	
●	8979K.314.018	1	
●	2979K.314.021	1	
●	8979K.314.021	1	

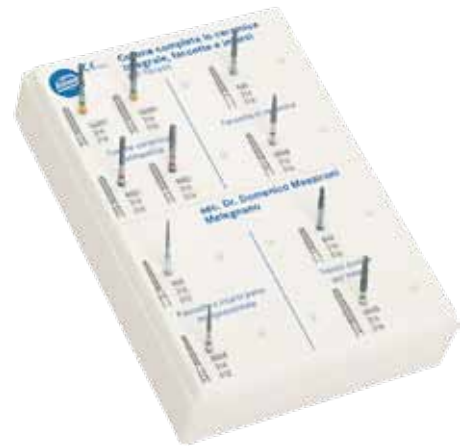

TD 1655.314
















Set corone complete in ceramica integrale, faccette e intarsi sec. Dr. Massironi, Melegnano

	846.314.016	1	
	868.314.012	1	
	868.314.016	1	
●	6848.314.018	1	
●	8868.314.012	1	
●	8868.314.016	1	
●	8881.314.014	1	
●	8881.314.016	1	
●	S6881.314.014	1	
●	S6881.314.016	1	



**TD 645.314**

Set per preparazioni protesiche sec. Dr. Castellani, Firenze







●	H46.314.012	1	
●	H46.314.014	1	
	H207.314.014	1	
	H23L.314.010	1	
●	H48L.314.012	1	
	369.314.025	1	
	801.314.014	1	
	846.314.016	1	
	847.314.016	1	
	848.314.016	1	
	862.314.012	1	
	886.314.016	1	
	878K.314.018	1	
	878K.314.021	1	
●	8886.314.016	1	



**TD 725.314**



Set per la preparazione protesica con disegno a chamfer modificato, cilindrico, sec. Dr. Massironi, Melegnano

●	2886.314.016	1	
●	2886.314.018	1	
●	2979.314.016	1	
●	2979.314.018	1	
●	8979.314.016	1	
●	8979.314.018	1	



**TD 860.314**



Set per la preparazione protesica con disegno a chamfer modificato, conico, sec. Dr. Massironi, Melegnano

32

●	2886K.314.021	1	
●	2886K.314.023	1	
●	2979K.314.021	1	
●	2979K.314.023	1	
●	8979K.314.021	1	
●	8979K.314.023	1	



**new**

**4646.000**



Kit Endo Access

○ ●	H4MCL.314.012	1	
○	4ZR.314.014	1	
●	H1SEM.205.018	1	
	857.314.014	1	
●	H1SML.205.010	1	
●	AK10L19.204.035	1	



**new**

**LD 1250 A.000**



Apertura Camera Pulpare Dr. Giuseppe Squeo-Bari

●	S6830L.314.012	1	
	H269GK.314.012	1	
	H269QGK.314.016	1	
●	H1SM.314.014	1	
	H1.316.012	1	
●	OP10L19.204.030	1	






**LD 0294.314**

Set H162SL per osteotomia, rizotomia, apicectomia, coronotomia





●	<b>H162SL.314.014</b>	12	
---	-----------------------	----	---



**LD 0347.000**

Set per piccola chirurgia orale








●	<b>H254E.314.012</b>	6	
●	<b>H254LE.314.012</b>	6	




**LD 0542.000**

Set per chirurgia orale sec. i Dottori Clauser e Barone, Firenze



	<b>H31LR.316.016</b>	2	
	<b>H31LR.310.016</b>	1	
	<b>H254.316.010</b>	1	
●	<b>H254LE.314.012</b>	1	
●	<b>H162SXL.314.014</b>	1	

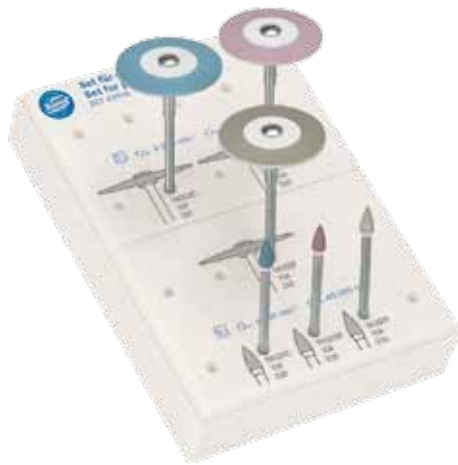

34

**4399 A.104**



Set per la lucidatura delle ceramiche

<b>9400C.104.030</b>	1		
<b>9400M.104.030</b>	1		
<b>9400F.104.030</b>	1		
<b>94003C.104.260</b>	1		
<b>94003M.104.260</b>	1		
<b>94003F.104.260</b>	1		



**SD 1873.000**



Set introduttivo con gommini Pin


<b>329A.104.</b>	3		
<b>9522C.900.030</b>	10		
<b>9522M.900.030</b>	10		
<b>9522F.900.030</b>	10		




**SORT 03 1.104**




Set introduttivo moscioni 9485C/M/F




**9485C.104.250** 2



**9485M.104.250** 2




**9485F.104.250** 2

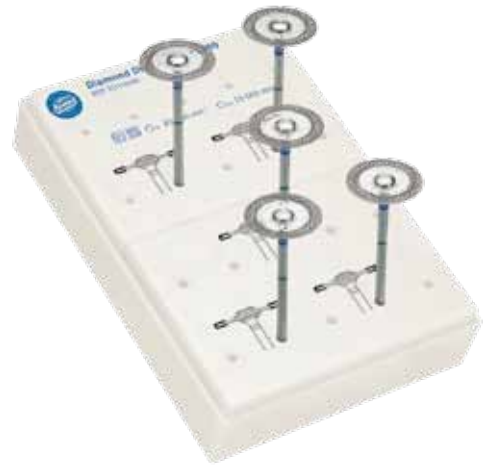


**TD 1160 A.104**



Set dischi diamantati



**6924.104.180** 5

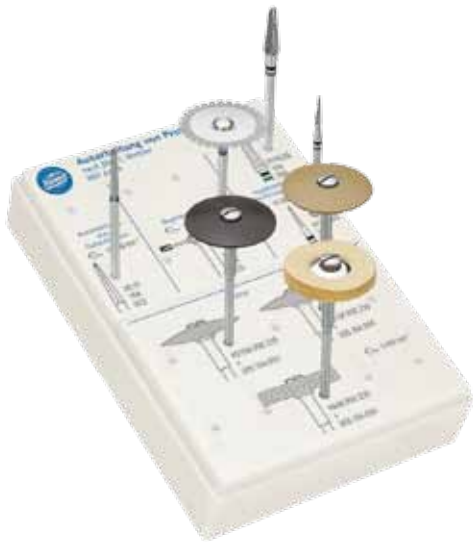

36

4409.000



Set per la lavorazione di provvisori secondo l'assistente dentale J. Mettler

H219.104.023	1	
946.104.220	1	
H79GSQ.104.040	1	
H136GSQ.104.016	1	
9515M.900.220	1	
9515F.900.220	1	
9448.900.220	1	
305.104.050	3	

4447.000




Set per la lavorazione di ZrO<sub>2</sub> secondo il tecnico Jan Holger Bellmann






ZR6881.314.016	1	
ZR6856.314.025	1	
ZR862.314.016	1	
ZR8881.315.016	1	
ZR8850.314.016	1	
ZR8379L.315.014	1	
ZR8801L.315.010	1	




**TD 1211.104**



Set minifresoni GTi per titanio



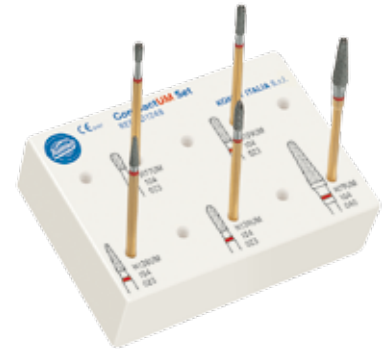


●	<b>H79GTI.104.040</b>	1		
●	<b>H129GTI.104.023</b>	1		
●	<b>H136GTI.104.016</b>	1		
●	<b>H138GTI.104.023</b>	1		
●	<b>H139GTI.104.023</b>	1		




**TD 1248.104**



Set minifresoni UM per leghe

●	<b>H77UM.104.023</b>	1		
●	<b>H129UM.104.023</b>	1		
●	<b>H138UM.104.023</b>	1		
●	<b>H139UM.104.023</b>	1		
●	<b>H79UM.104.040</b>	1		

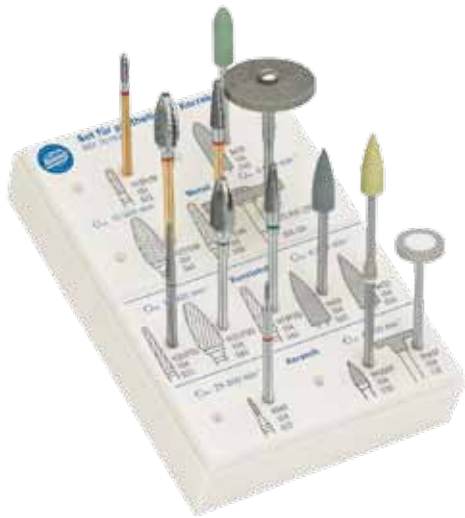

**38 TD 1520 A.000**




Set per correzioni protesiche

●	H139UM.104.023	1	
	9620.104.045	1	
●	H251UM.104.060	1	
●	H79UM.104.040	1	
	9675.900.220	1	
	305.104.050	1	
●	H261FSQ.104.023	1	
●	H251FSQ.104.060	1	
●	H79FSQ.104.040	1	
	9424.104.055	1	
	9433.104.055	1	
●	8860.104.012	1	
	94000F.104.030	1	
	9545F.104.110	1	

**TD 2041.314**





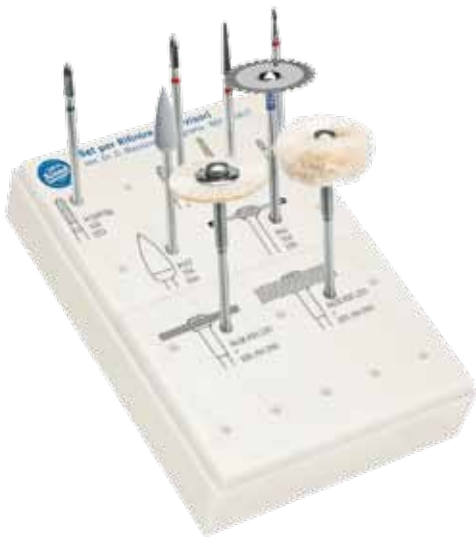









Lavorazione di abutment in titanio con turbina da laboratorio sec. Od. J.H. Bellmann


●	H373Q.314.021	1	0°
●	H373F.314.021	1	0°
●	H371Q.314.025	1	2°
●	H371F.314.025	1	2°
●	H376Q.314.025	1	4°
●	H376F.314.025	1	4°



**TD 2817.104**





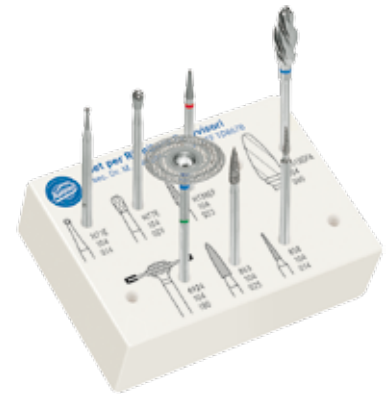






Set per rifinire i provvisori sec. Dr. Massironi, Melegnano

			
	<b>H139FSQ.104.023</b>	1	
	<b>H139EF.104.023</b>	1	
	<b>H261EF.104.023</b>	1	
	<b>H73EF.104.014</b>	1	
	<b>9557.104.060</b>	1	
	<b>9638.900.220</b>	1	
	<b>9628.900.220</b>	1	
	<b>305.104.050</b>	1	
	<b>946.104.220</b>	1	



**TD 867 B.104**

Set per Rifinitura Provvisori sec. Dr. M. Fradeani, Pesaro

			
	<b>H71E.104.014</b>	1	
	<b>H77E.104.029</b>	1	
	<b>H138EF.104.023</b>	1	
	<b>H251SGFA.104.060</b>	1	
	<b>6924.104.180</b>	1	
	<b>863.104.025</b>	1	
	<b>858.104.014</b>	1	

Komet Italia S.r.l.  
Via Fabio Filzi 2 · 20124 Milano

Telefono 02 67076654  
Telefax 02 67479318  
info@komet.it  
www.komet.it

